


Mirage FX e Mirage FX for her

1. Stampa il PDF in dimensioni reali, controllare che la dimensione sia corretta posizionando la tessera sanitaria nel riquadro apposito.
2. Tagliare il misuratore lungo la linea tratteggiata
3. Posizionare il misuratore sotto il naso, come mostrato nell'immagine sottostante per verificare qual è la taglia corretta.

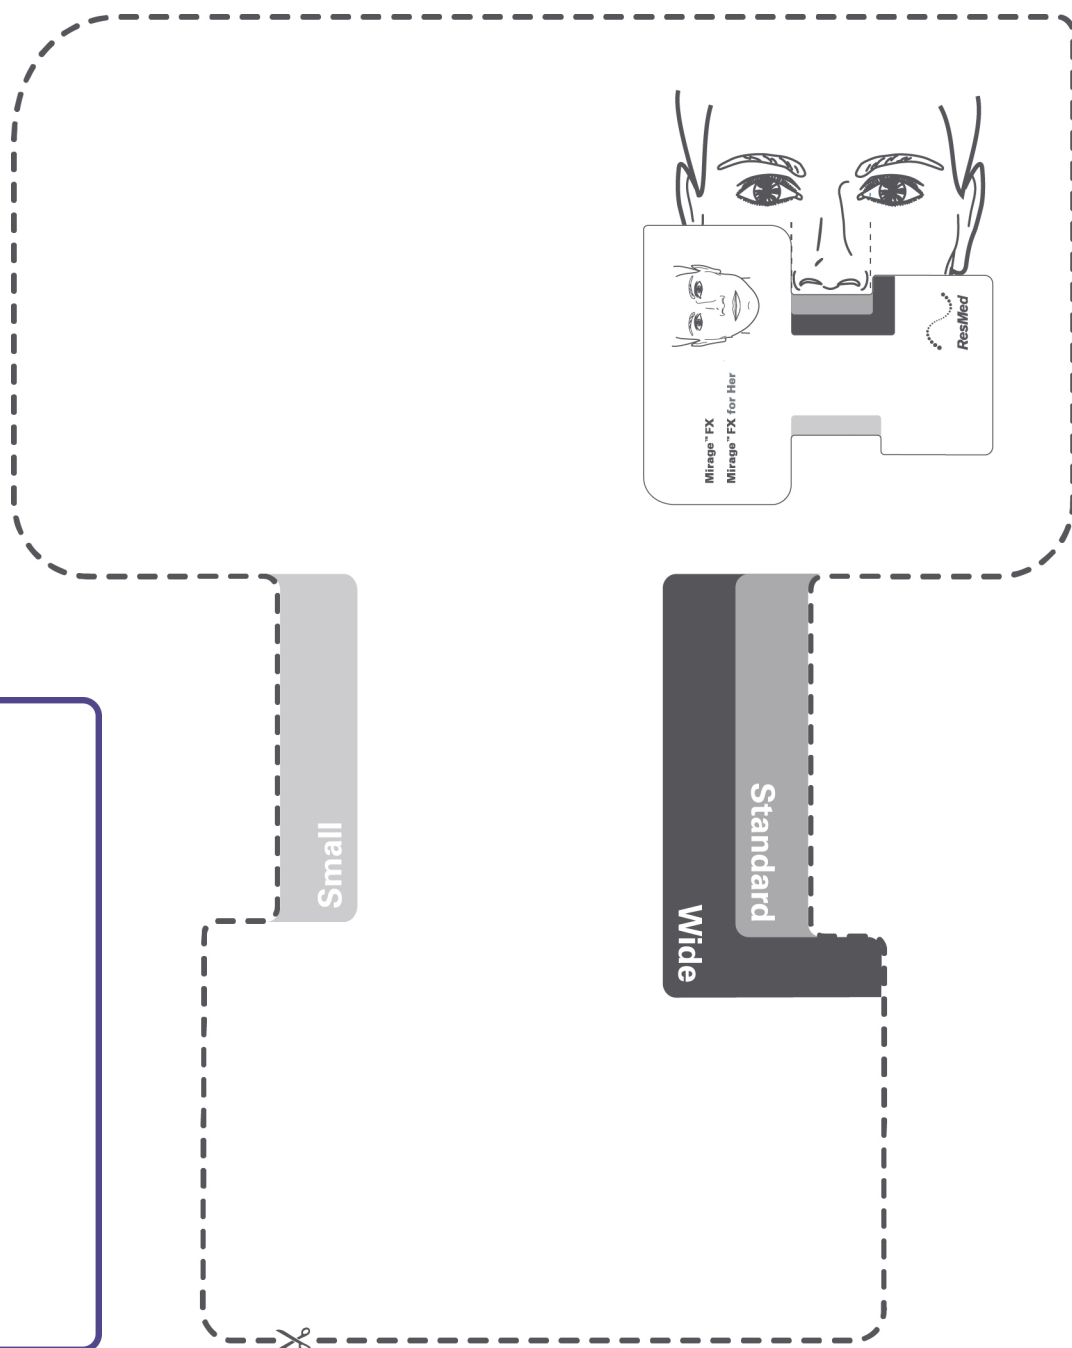

Inserisci qui la tessera sanitaria
per controllare di aver stampato
il misuratore della misura giusta